成品尺寸130x200mm单黑，骑马钉

CE 0123

RespiroX

KULLANIM KILAVUZU

Dijital Tansiyon Aleti

MODEL: 3002



Yayın Tarihi: 30.01.2026

Lütfen ürünü kullanmadan önce bu kullanım kılavuzunu dikkatlice okuyun.
Bu ürün sağlık çalışanları veya test edilen kişi tarafından kullanılabilir.

I.Ürün Adı: Dijital Tansiyon Aleti Koldan
II.Ürün Modeli: 3002
III.Uygulama Alanı: Bu ürün, yetişkinlerde sistolik kan basıncını (SBP), diyastol kan basıncını (DBP) ve nabız hızını (PR) ölçmek için tasarlanmıştır. Ölçülen değerler tanısal referans olarak kullanılabilir.
IV. Ürün Yapısı ve Bileşenleri: Dijital Kol Kan Basıncı Monitörü esas olarak bir ana makine ve bir kol başlığından oluşur.

V. Ürünün Fonksiyon ve Teknik Paremetreleri:

Ürün Adı	Dijital Kol Tipi Tansiyon Ölçüm Cihazı
Ekran Modu	Dijital sıvı kristal ekran (LCD)
Ölçüm Yöntemi	Osilometrik ölçüm
Ölçüm Birimi Değişimi	Ölçüm birimi ihtiyaca göre mmHg ve kPa arasında değiştirilebilir
Ölçüm Aralığı	Kan Basıncı (BP): 0 mmHg (0 kPa) – 280 mmHg (37.3 kPa) Diyastolik Basınç (DBP): 30 mmHg (4.0 kPa) – 200 mmHg (26.6 kPa) Sistolik Basınç (SBP): 50 mmHg (6.7 kPa) – 255 mmHg (33.9 kPa) Nabız (PR): 40 – 180 atım/dakika
Ölçüm Doğruluğu	Ortam koşullarında sfigmomanometre hata sınırları: Manşon basıncının maksimum ölçüm hatası, nominal ölçüm aralığının herhangi bir noktasında ±3 mmHg (±0.4 kPa) veya okunan değerin %±2'sinden (hangisi büyükse) küçük veya eşit olmalıdır. Çalışma koşulları: 10°C – 40°C sıcaklık aralığı ve %15 – %85 bağıl nem (yoğuşma olmadan). Nabız ölçüm doğruluğu: ±%5
Hafıza Kapasitesi	Bu cihaz, iki kullanıcı için ayrı ayrı 99 ölçüm sonucu saklayabilir
Dahili Güç Kaynağı	AA pil ×4, DC 6V
Düşük Pil Uyarısı	Pil seviyesi düşük olduğunda, ekran üzerindeki güç sembolü yanıp sönerek pilin değiştirilmesi gerektiğini hatırlatır
Aritmi Uyarısı	Bu cihaz, dakikadaki kalp atım sayısının normal olup olmadığını tespit edebilir ve ölçüm sonuçlarını ekran sembolünün yanıp sönmesi ve sesli uyarı ile gösterebilir
Çalışma Moduna Göre Sınıflandırma	Sürekli çalışma
Çalışma Ömrü	Cihaz 10.000'den fazla ölçümde normal şekilde çalışabilir
Uygulanabilir Kol Çevresi	22 – 36 cm
Elektrik Çarpmasına Karşı Koruma	Dahili güç kaynaklı ekipman, Sınıf II, BF tipi uygulama parçası
Çalışma Ömrü	Cihaz 10.000'den fazla ölçümde normal şekilde çalışabilir
Uygulanabilir Kol Çevresi	22 – 36 cm
Elektrik Çarpmasına Karşı Koruma	Dahili güç kaynaklı ekipman, Sınıf II, BF tipi uygulama parçası
Sıvı Girişine Karşı Koruma Sınıflandırması	IP20
Uygulanan Parçalar için Standart	BF tipi uygulama parçaları standardı
Kapanma Modu	Manuel kapatma / 4 dakika işlem yapılmadığında otomatik kapanma
Ana Aksesuarlar	Dijital Kol Tipi Tansiyon Ölçüm Cihazı, kullanım kılavuzu ve sertifika

Çalışma Ortamı	Sıcaklık: 5°C – 40°C Bağıl nem: %15 – %85 Atmosfer basıncı: 80.0 kPa – 105.0 kPa
Depolama Ortamı	Sıcaklık: -20°C – 55°C Nem: %10 RH – %93 RH
Üretim Tarihi	Ürün etiketi üzerinde belirtilmiştir
Geçerlilik Süresi / Hizmet Ömrü	5 yıl
Uygulanan Parça	Kol manşonu
Kol Manşonunun Nominal Basınç Aralığı	0 – 360 mmHg

Yazılım Versiyonu: AXD-901-X0-Y0-Z0-A0
Donanım Yapılandırması: Mikrodenetleyici (SZC909), LCD ekran, fonksiyon tuşu, basınç sensörü, hava pompası, solenoid valf ve basınç tahliye valfi
Yazılım Ortamı / Geliştirme Araçları: Keil5 UV5


VI. ⚠ Güvenli Kullanım Talimatları, Uyarılar ve Kontrendikasyonlar
Lütfen ürünü kullanmadan önce kullanım kılavuzunu dikkatlice okuyunuz.
Hasta, cihazın kullanım amacı doğrultusunda hedeflenen kullanıcıdır.
Hasta, cihazın kullanım amacı doğrultusunda hedeflenen kullanıcıdır.
Dijital Kol Tipi Tansiyon Ölçüm Cihazı ve güç adaptörü birlikte bir ME (Tıbbi Elektrikli) sistem oluşturur.
Ancak ölçüm sonuçlarını hastanın kendi başına yorumlaması ve tedavi uygulaması tehlikelidir.
Lütfen ölçüm sonuçlarını doğru bir teşhis için doktora iletiniz.
İlaç kullanımı konusunda doktorunuzun tavsiyelerine uyunuz.
Bazı hastalıkların neden olduğu periferik dolaşım bozukluğu olan kişilerde, bilekten ve üst koldan ölçülen tansiyon değerleri önemli ölçüde farklılık gösterebilir.
Bu cihazın kan basıncı (BP) ve nabız (PR) ölçümü dışında başka amaçlarla kullanılması yasaktır.
Kol manşonu basıncının 299 mmHg (39.9 kPa) değerini aşmamasına dikkat ediniz.
Üretici tarafından sağlanmayan bileşenlerle orijinal parçaların değiştirilmesi ölçüm hatalarına neden olabilir.
Yetkisiz olarak bu cihazın sökülmesi, onarılması veya değiştirilmesi yasaktır.
Tansiyon ölçümünden en az 30 dakika önce yoğun fiziksel aktivitelerden kaçınınız, sigara içmeyiniz ve kahve veya alkol gibi uyarıcı içecekler tüketmeyiniz.
Ölçümden önce rahat ve sabit bir ortamda, oturur pozisyonda en az 5 dakika dinleniniz.
Ölçümü sabit bir zaman diliminde, sabit bir pozisyonda, aynı kolda ve aynı tansiyon ölçer ile gerçekleştiriniz.
İlk tansiyon ölçümünde, ölçüm yapılacak kolu belirlemek için her iki koldan da ölçüm yapılması önerilir.
Ölçüm en az iki kez yapılmalı ve iki ölçüm arasındaki süre 5 dakikadan az olmamalıdır.
Aritmi ve arteriosklerozu olan hastalarda ölçüm sonuçları doğru olmayabilir. Doğru bir teşhis için ölçümün sağlık profesyonelleri tarafından yapılması önerilir.
Kol manşonunun uzun süre aşırı şişirilmesi, kan damarlarının sıkışmasına neden olabilir.
Bu durumda manşondaki havayı boşaltmak için cihazın güç kaynağını kapatınız.
Hasta yatakta hareket edemiyorsa veya hareket kısıtlılığı varsa, doğru teşhis için ölçümün aile bireyleri veya sağlık personeli yardımıyla yapılması önerilir.
Bu ürün, elektro cerrahi girişimler sırasında kullanıma uygun değildir. Yüksek frekanslı cerrahi aletler kullanılırken bu ürünün kullanılması yasaktır.
Bu modeldeki elektronik tansiyon ölçer; yenidoğanlar, küçük çocuklar, hamile kadınlar ve preeklampsi hastaları için tasarlanmamıştır.

Bu cihaz, en az 15 yaşında ve temel eğitimi olan kullanıcılar için uygundur.
Cihaz şarj olurken çalışabilir, ancak şarj sırasında tansiyon ölçümü yapılması yasaktır.
Cihazın gövdesi ve kol manşonu, insan cildiyle temas ettiğinde alerjik reaksiyonlara neden olabilir. Alerjik bir reaksiyon durumunda cihazın kullanımı derhal durdurulmalı ve tıbbi yardım alınmalıdır.
Yüksek frekanslı elektromanyetik vericilerin yakınında cihazın kullanılması yasaktır.
YY9706.102-2021 standardında belirtilen gereklilikleri aşan elektromanyetik girişimler, cihazın performansını olumsuz etkileyebilir.
Yanıcı gazlar, oksijen veya anestezik gaz karışımları bulunan ortamlarda cihazın kullanılması yasaktır.
Cihazın nemli ve tozlu ortamlarda saklanması yasaktır. Ayrıca cihazın doğrudan güneş ışığına maruz bırakılması, performansını olumsuz etkileyebilir.
Kazaları önlemek için cihazın çocukların erişemeyeceği güvenli bir yerde saklanması gereklidir.
Bu cihazın USB kablo uzunluğu 1 metredir. Kullanım sırasında boğulma veya dolanma riskine karşı dikkat edilmelidir.
Ölçüm sonrasında cihazı evcil hayvanların ve çocukların erişemeyeceği bir yerde muhafaza ediniz, böylece cihazın düşmesi, hatalı ölçüm yapması veya arızalanması önlenir.
Bu cihaz, diğer cihazlarla birlikte veya bağlantılı olarak kullanılamaz.
Cihaz kullanılırken sabit ve sessiz bir ortamda kullanılmalıdır; kullanım sırasında veri aktarımı yapılması yasaktır.
Bu cihaz yalnızca kan basıncı ölçümü için kullanılır ve diğer yazılımlarla arayüz bağlantısını desteklemez.
Cihazın yazılımı entegre devre (IC) çipi içine gömülüdür ve başka donanımlara kurulamaz veya çalıştırılamaz.
Yetkisiz olarak cihazın sökülmesi veya değiştirilmesi yasaktır.
Bu ürün, kamuya açık alanlarda veya acil tıbbi hizmet ortamlarında bireysel kullanım için tasarlanmamıştır.
Uyarı: Cihaz üzerinde herhangi bir değişiklik yapılması yasaktır.

> ⚠ Uyarı
> Yetkisiz olarak cihazın sökülmesi, onarılması veya değiştirilmesi yasaktır.
> Bu tür işlemler sonucunda ortaya çıkabilecek ürün kalite sorunları ve kişisel güvenlik riskleri tamamen kullanıcının sorumluluğundadır.

VII. Kullanım Talimatları


1. Kullanım Öncesi Hazırlık

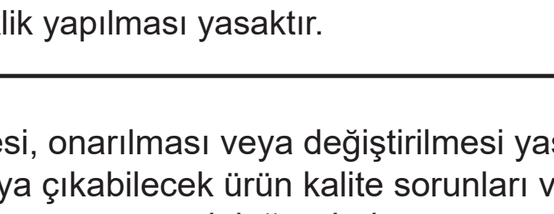


1.1 Pil kapağının çıkarılması
Pil bölmesi, tansiyon ölçüm cihazının alt kısmında yer almaktadır.
1.2 Pilin takılması
Pilleri, şekilde gösterildiği gibi yerleştiriniz.
Ok yönünde pil kapağını çıkarınız.
2. Pilin "+" ve "–" kutuplarını doğruladıktan sonra 1,5 V AA alkalin pilleri yerleştiriniz.
3. "Klik" sesi duyulana kadar pil kapağını kapatınız.
Not:
Pilin kutuplarına (polarite işaretlerine) dikkat ediniz.
Cihaz açıldıktan sonra ekranda düşük pil sembolü görüntülenirse, ölçüm yapılamaz. Bu durumda pil değiştirilmelidir veya GB9706.1 standardı gerekliliklerini karşılayan bir güç adaptörü kullanılmalıdır.


Önerilen adaptör modeli: UES10L2-C-050200SPA (Giriş: 100–240 V~ 50/60 Hz 0.5 A, Çıkış: DC 5.0 V / 2 A) Adaptör kullanılırken, fişin çıkarılmasının zor olduğu bir prize bağlanmayınız. Adaptör kullanımı sırasında, pillerin çıkarılması önerilir. Bu durum, bileşen arızalarından (kod hataları) kaynaklanan pilin ters şarj olmasını önler ve pil ömrünü uzatır.
Ölçüm sırasında, sağdaki şekilde gösterildiği gibi elektrik yetersizliği sembolü görüntülenirse
Başlat/Durdur (Start/Stop) tuşuna basılmasına rağmen ekranda görüntü oluşmazsa
Lütfen 4 adet alkalin kuru pil kullanınız.
Son kullanma tarihi geçmiş pilleri kullanmayınız.
Ürün uzun süre kullanılmayacaksa, pilleri cihazdan çıkarınız.
Piller ve elektronik cihazlar, yerel mevzuata uygun şekilde bertaraf edilmelidir.
Evsel atıklarla birlikte rastgele atılması yasaktır.

2. Ürün Bileşenlerinin Tanıtımı

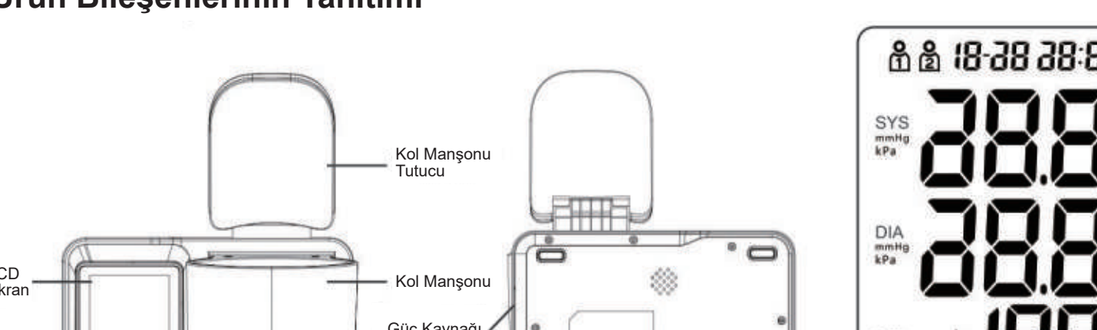

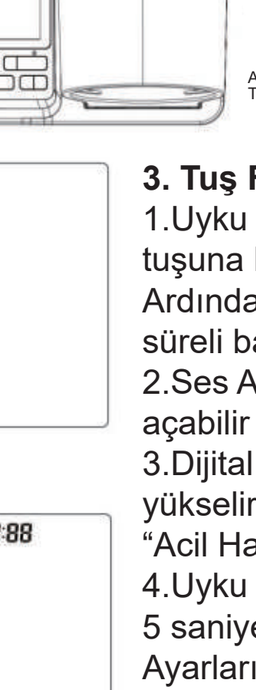


3. Tuş Fonksiyonları ve Kullanım Talimatları
1.Uyku modundayken, kullanıcı seçimine girmek için Ayar (SET) tuşuna kısa süreli basınız.
Ardından kullanıcı 1 veya kullanıcı 2'yi seçmek için tuşa tekrar kısa süreli basınız.
2.Ses Açma/Kapama tuşuna basarak sesli uyarı fonksiyonunu açabilir veya kapatabilirsiniz.
3.Dijital tansiyon ölçüm cihazı şişirme aşamasındayken basınç çok yükselir ve kolda ağrıya neden olursa, basıncı derhal boşaltmak için "Acil Hava Tahliye" tuşuna kısa süreli basınız.
4.Uyku modundayken, fonksiyon ayarlarına girmek için SET tuşuna 5 saniye boyunca basılı tutunuz.
Ayarları değiştirmek için "< / >" tuşlarını kullanınız.
Ayarların ekranda görüntülenme sırası aşağıdaki gibidir:
1. Yıl Ayarı
Yılı 2024 – 2099 aralığında ayarlamak için "< / >" tuşlarına basınız.
Ayarı onaylayıp ay ayarına geçmek için SET tuşuna basınız.
2. Ay Ayarı
Ayı 1 – 12 aralığında ayarlamak için "< / >" tuşlarına basınız.
Ayarlandıktan sonra tarih ayarına geçmek için SET tuşuna basınız.
3. Tarih Ayarı
Tarihi 1 – 31 aralığında ayarlamak için "< / >" tuşlarına basınız.
Ayarlandıktan sonra saat ayarına geçmek için SET tuşuna basınız.
4. Saat Ayarı
Saati 0 – 23 aralığında ayarlamak için "< / >" tuşlarına basınız.
Ayarlandıktan sonra dakika ayarına geçmek için SET tuşuna basınız.




5. Dakika Ayarı
Dakikayı 0 – 59 aralığında ayarlamak için "< / >" tuşlarına basınız.
Ayarlandıktan sonra ölçüm birimi ayarına geçmek için SET tuşuna basınız.
6. Ölçüm Birimi Ayarı
Ölçüm birimini ayarlamak için "< / >" tuşlarına basınız. kPa veya mmHg birimlerinden birini seçiniz. Ayarları tamamlamak için SET tuşuna basınız.
7. Hafızanın Temizlenmesi
Hafıza görüntüleme modundayken, MEM ve SET tuşlarına aynı anda 3 saniye boyunca basılı tutunuz.
Ekranda ilgili simge görüntülendiğinde, tüm hafıza kayıtları silinmiş olur.

4. Kullanım Yöntemleri
4.1 Kol Manşonunun Kullanımı
Ölçüm sırasında kolunuzu açıkta bırakınız veya dar olmayan, kola tam oturan giysiler giyiniz.
Kazak, mont veya kalın giysiler giyilirken kolu sıvayarak ölçüm yapmak yasaktır; bu tür giysiler ölçüm öncesinde çıkarılmalıdır.


1. Kol Manşonunun Açılması

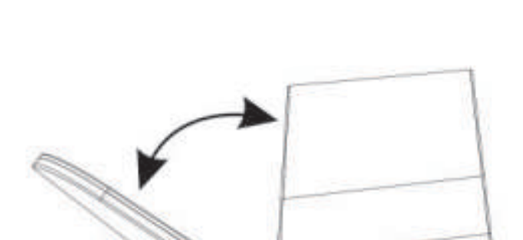

2. Sol kolunuzu kol manşonunun içerisine koyun.

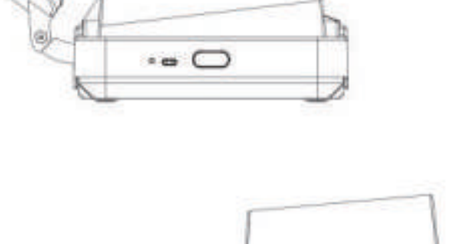

3. Dirseğinizi, kolunuzun yerleştirildiği çukura yerleştirin.

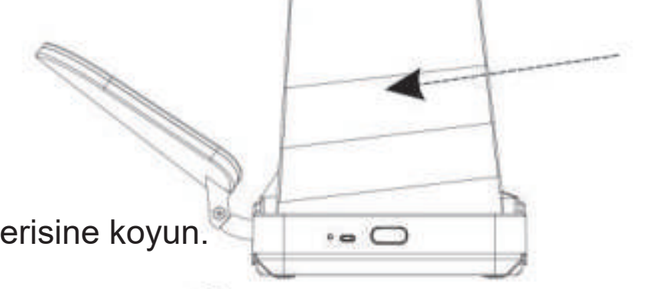

4.2 Doğru Ölçüm Pozisyonu
Ölçüm sırasında rahat olunmalı ve dik bir pozisyonda oturulmalıdır. Ortam sıcaklığı uygun olmalıdır.
Ölçümden 30 dakika önce yemek yemek, içecek tüketmek, sigara içmek, egzersiz yapmak ve banyo yapmak yasaktır.
● Rahat bir oturma pozisyonu sağlayınız.
● Her iki ayağınız yere düz basacak şekilde bir sandalyede oturunuz.
● Dik oturunuz.
● Bacaklar çapraz olmamalıdır.
● Sırt ve kollar desteklenmelidir.
● Kol manşonu kalp hizasında tutulmalıdır.
● Kol manşonunun orta noktası kalp ile aynı hizada olmalıdır.

4.3 Etkili Ölçüm İçin Önlemler
● Ölçümden önce yemek yemek, sigara içmek veya ağır fiziksel aktiviteler yapmak kaçınılmalıdır.
● Ölçümden önce, mümkünse sessiz bir ortamda sandalyede yaklaşık 10 dakika dinleniniz.
● Ölçüm sırasında rahat ve gevşemiş durumda olunuz; ölçüm esnasında kol kaslarını kasmak yasaktır.
● Gerekirse, cihazı desteklemek için yumuşak bir yastık kullanılabilir.
● Avuç içi doğal şekilde yukarı bakacak biçimde, dirseğinizi kol manşonunun alt kısmındaki oyuk bölgeye yerleştiriniz; böylece kol manşonunun orta noktası kalp hizasında olur.
● Sol koldan ölçüm yapılamıyorsa, ölçüm sağ koldan yapılabilir.
Ancak ölçüm sonuçlarının karşılaştırılabilmesi için, her zaman aynı koldan (genellikle sol kol) ölçüm yapılması gereklidir.

4.4 Kan Basıncı Ölçümü
a) Başlat/Durdur (Start/Stop) tuşuna basınız, kol manşonu otomatik olarak şişmeye başlayacaktır.
Nabız algılandığında, ekranda ♥ (kalp) sembolü görüntülenir ve yanıp sönmeye başlar.
b) Ölçüm tamamlandıktan sonra, ölçüm sonuçları sesli olarak anons edilir.

⚠ Not:
● Kan basıncı aynı gün içinde bile değişkenlik gösterebildiğinden, her gün düzenli ölçüm yapılması gereklidir.
● Yeni bir ölçüm almadan önce, damarların eski haline dönebilmesi için en az 5 dakika beklenmelidir.
● Kullanıcı ölçümü iptal etmek isterse, Başlat/Durdur (Start/Stop) tuşuna basmalıdır. Bu durumda cihaz, kol manşonundaki havayı otomatik olarak boşaltır ve ölçümü iptal eder.
● Ölçüm süresince rahat ve sessiz bir ortam sağlanması gereklidir.

⚠ Uyarılar ve Güvenli Kullanım Talimatları
1.Cihazın çok sık kullanılması yasaktır. Aşırı kullanım, kan akışında bozulmaya ve kol dokusunda hasara neden olabilir.
2.Kolda açık yara bulunması durumunda, tansiyon ölçümü için kol manşonunun kola takılması yasaktır; bu durum yaralanmanın artmasına neden olabilir.
3.Damar içi girişim, tedavi veya arteriyovenöz (A-V) şant uygulanan koldan tansiyon ölçümü yapılması yasaktır. Bu durum kan akışını bozarak hasara yol açabilir.

4.Mastektomi veya lenf nodu rezeksiyonu geçirmiş hastalarda, ölçümün sağlık profesyonellerinin gözetiminde yapılması gereklidir. Hastaların ölçümü kendi başlarına yapmaları yasaktır.
5.Kol manşonunun şişirilmesi, aynı uzuvda kullanılan tıbbi elektrikli (ME) cihazın geçici olarak fonksiyon kaybına uğramasına neden olabilir. Bu nedenle ölçüm sağlık profesyoneli rehberliğinde yapılmalıdır.
6.Bağlantı hortumunun bükülmesi nedeniyle oluşan sürekli manşon basıncı, kan akışını bozabilir ve hastaya zarar verebilir. Cihazın çalışması sırasında, hastanın kan dolaşımında uzun süreli hasar oluşmasını önlemek için ölçüm yapılan kol düzenli olarak kontrol edilmelidir.

4.5 Ekran Görüntüsünde Anormallikler ve Sorun Giderme
a) Ölçüm Sırasında Ekranda Görülen Anormallikler ve Çözümleri

Sembol	Neden	Çözüm
E-U	Aşırı basınç (295 mmHg), 3 saniyeden uzun süren otomatik hızlı hava boşaltma	Ölçümü durdurun, manşonun doğru takıldığını kontrol edin ve tekrar ölçüm yapın
E-H	Aşırı basınç (295 mmHg), 3 saniyeden uzun süren otomatik hızlı hava boşaltma	Ölçümü durdurun, manşonun doğru takıldığını kontrol edin ve tekrar ölçüm yapın
E-1	Hava kaçağı hızı çok yüksek veya ölçüm yapılan kişinin nabız sinyali çok zayıf	Manşonu yeniden takın, doğru pozisyonu sağlayın ve ölçümü tekrar edin
E-2	Ölçüm sırasında aşırı girişim (titreme, konuşma, manyetik etki vb.)	Ölçüm sırasında hareketsiz ve sessiz olun
E-3	Anormal ölçüm sonucu	Ölçümü tekrar edin
(pil simgesi)	Pil seviyesi düşük	4 adet yeni alkalin pil değiştiriniz

b) Sorun Giderme

Anormallik	Kontrol Edilecek Husus	Çözüm Yöntemi
Açma/Kapama tuşuna basıldıktan sonra ekranda hiçbir şey görüntülenmiyor	Pil seviyesinin düşük olup olmadığını kontrol ediniz	Cihazı zamanında şarj ediniz / pilleri değiştiriniz
Basınç oluşmuyor	Kol manşonunun hava torbasında yırtık olup olmadığını kontrol ediniz	Cihazı onarım için üreticiye gönderiniz
Ölçüm hatasıyla ilgili uyarılar	Ölçüm sırasında kolun hareket edip etmediğini kontrol ediniz Ölçüm sırasında kullanıcının konuşup konuşmadığını kontrol ediniz	Ölçüm sırasında kolu ve vücudu sabit tutunuz Tansiyon ölçümü sırasında sessiz olunuz
"Hafıza (Memory)" tuşuna basıldığında ekranda hiçbir şey görüntülenmiyor	Cihazın hafıza modunda olup olmadığını kontrol ediniz	Önce cihazı kapatınız, ardından tekrar açarak ölçüm yapınız

⚠ Uyarı:
Yukarıdaki yöntemlerle tansiyon normal şekilde ölçülemiyorsa, satıcı ile iletişime geçiniz.
Yetkisiz olarak cihazın sökülmesi kesinlikle yasaktır.

4.6 Tansiyon (BP) ile İlgili Yaygın Sorular
Tansiyonun Tanımı
Kan basıncı (BP), kalbin kasılması ve gevşemesi sırasında dolaşan kanın, atardamarların iç duvarlarına uyguladığı hidrostatik basınç olarak tanımlanır.
Kalp kasıldığında kanın atardamarlara gönderilmesiyle oluşan basınç Sistolik Kan Basıncı (SBP) olarak adlandırılır.
Kan dolaşımı tamamlandıktan sonra, kan kalbe geri döner ve kalp gevşediğinde oluşan basınç Diyastolik Kan Basıncı (DBP) olarak adlandırılır.

5. Kan Basıncı Sınıflandırma Kriterleri ve Gösterimi
a) Kan Basıncı Sınıflandırma Kriterleri
Dünya Sağlık Örgütü (WHO) tarafından önerilen standart kan basıncı değerleri, aşağıdaki şekilde gösterilmektedir.
※ Hipotansiyon (düşük tansiyon) sınıflandırması tanımlanmamıştır.

6. Pil Kullanımıyla İlgili Önlemler
a) Yalnızca 4 adet alkalin pil kullanınız. Başka tür pillerin kullanılması yangın riski oluşturabilir.
Pil içindeki elektrolitin kazara göze temas etmesi durumunda, derhal bol su ile yıkayınız. Körlük ve diğer yaralanma riski bulunduğundan, en yakın sağlık kuruluşuna başvurunuz.
b) Pil elektroliti cilt veya giysilere bulaşırsa, derhal bol su ile durulayınız; aksi takdirde cilt hasarı oluşabilir.
Pilleri yanlış kutup yönünde (+/–) takmayınız.
Piller tükendiğinde, 4 adet yeni alkalin pili aynı anda değiştiriniz.
Cihaz 3 aydan uzun süre kullanılmayacaksa, pilleri çıkarınız; aksi hâlde pil sızıntısı, aşırı ısınma, patlama ve tansiyon ölçüm cihazında hasar meydana gelebilir.
c) Eski ve yeni pilleri veya farklı tipte pilleri birlikte kullanmayınız; bu durum pil sızıntısına, aşırı ısınmaya, patlamaya ve cihaza zarar verebilir.
Kullanılmış piller, bulunduğunuz il/ilçe/beldeye ait çevre koruma mevzuatına uygun şekilde bertaraf edilmelidir.
Pillerin yakıt olarak yakılması yasaktır; bu durum pil patlamasına ve ciddi yanıklara veya yaralanmalara neden olabilir.

Bioland Technology Ltd.
No. A6B7 (Block G) ShangRong Industrial Zone
No.5 Baolong Road, Baolong Community Longgang District
518116, Shenzhen, Guangdong P.R.C

EC REP **Shanghai International Holding Corp. GmbH (Europe)**
Address: Eiffestrasse 80, 20537, Hamburg, Germany

ECE TIBBİ CİHAZLAR VE MEDİKAL SAN. TİC. AŞ.
Cihangir Mah. Kemal Türkler Sok. No: 5/1
Avcılar/ İstanbul/ TÜRKİYE Tel: 444 78 96
www.ecemedikal.net / www.respirox.com.tr